
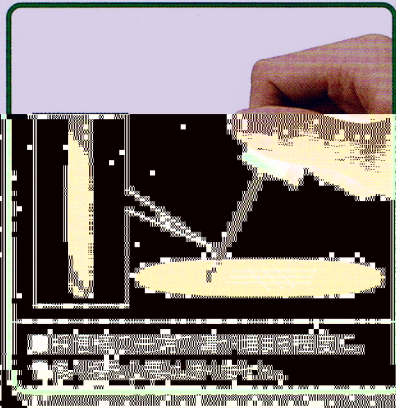


検体採取法

緑色のキャップをひねりながら引き抜きます。

採便棒で、便の表面をまんべんなくこすりとりか、数箇所を突き刺して採取します。

採便棒を1回だけ容器に入れて、ひねって締めます。


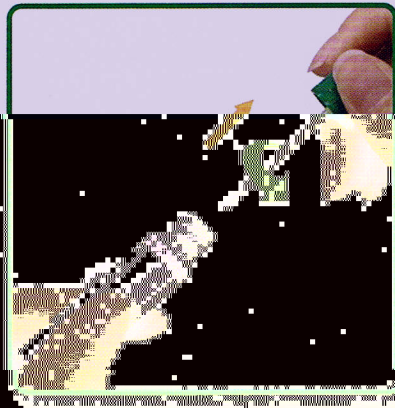


操作方法

便便を採った検体採取容器をキャップをひねりし、蓋を閉めておきます。検体採取容器は、室温で保存します。


ストリッパを検体採取容器に挿入して、気泡を飛ばします。

8分間、1日8本の検体採取容器を測定します。

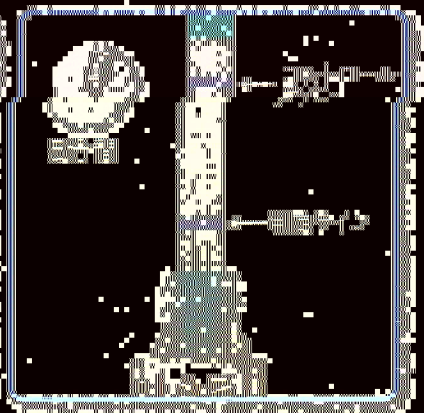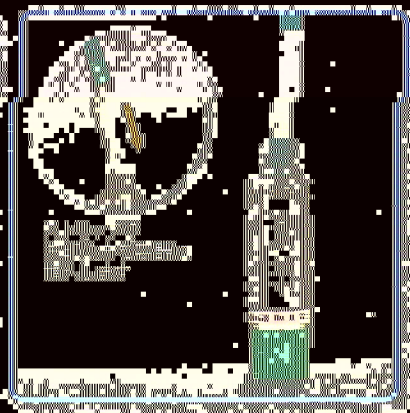


測定結果の判定法


底面開始の便検体にストリッパのインジケータが検出され、検出インジケータが検出されて測定結果が判定されます。

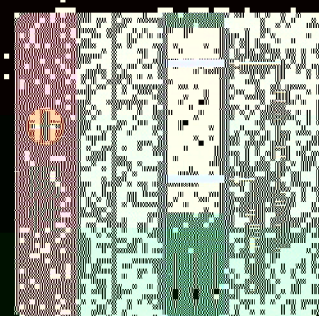


検出インジケータが検出され、検出インジケータが検出されて測定結果が判定されます。

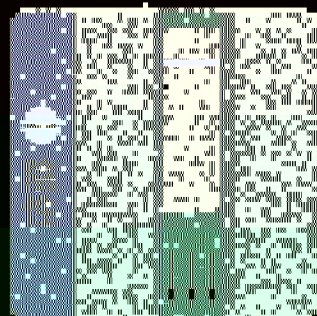

検出インジケータが検出され、検出インジケータが検出されて測定結果が判定されます。

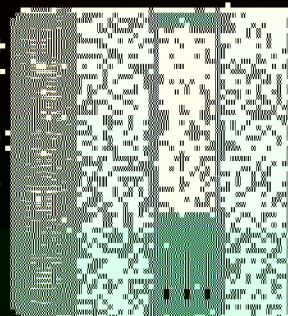

検出インジケータが検出され、検出インジケータが検出されて測定結果が判定されます。

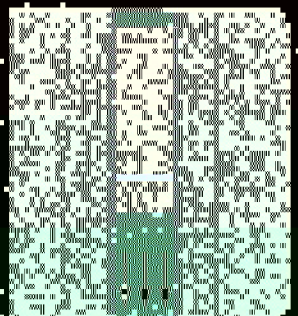

検出インジケータが検出され、検出インジケータが検出されて測定結果が判定されます。

検出インジケータが検出される

検出インジケータが検出される

検出インジケータが検出される

検出インジケータが検出される